

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

⑤

Int. Cl. 2:

A 61 N 3-00

①⑨ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

DT 24 39 587 A1

⑪

# Offenlegungsschrift 24 39 587

⑫

Aktenzeichen:

P 24 39 587.7

⑬

Anmeldetag:

17. 8. 74

⑭

Offenlegungstag:

27. 2. 75

⑮

Unionspriorität:

⑳ ㉑ ㉒

23. 8. 73 Großbritannien 39991-73

⑤④

Bezeichnung:

Elektrochirurgische Vorrichtung

⑦①

Anmelder:

Matburn (Holdings) Ltd., London

⑦④

Vertreter:

Redies, F., Dr.-Ing. Dr.jur.; Redies, B., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Türk, D., Dr.;  
Gille, Ch., Dipl.-Ing.; Pat.-Anwälte, 4000 Düsseldorf

⑦②

Erfinder:

Blackett, John Horold, London

DT 24 39 587 A1

ORIGINAL INSPECTED

② 2.75 509 809/368

4/60

Copied from 10728212 on 08/30/2005

G 49 584 -su

Firma Matburn (Holdings) Limited, Three Colts Lane,  
Bethnal Green, LONDON E.2. (England)

-----  
Elektrochirurgische Vorrichtung  
-----

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrochirurgische Vorrichtung.

Eine solche Vorrichtung ist mit einer Elektroschockgefahr bzw. einer Gefahr elektrischer Stöße verbunden. Das gilt vor allem bei einem elektrochirurgischen Generator, dessen Elektroden direkt mit einem Patienten verbunden sind.

Bei einem herkömmlichen elektrochirurgischen Generator ist eine Plattenelektrode mit Erde bzw. Masse verbunden, wodurch der Körper des Patienten direkt an Erde bzw. Masse liegt. Einer der wesentlichsten Anlässe für einen elektrischen Stoß ist das Fließen eines elektrischen Stroms von einer unter Spannung stehenden Quelle, die sich in Berührung mit dem Patienten befindet, über die Plattenelektrode zur Masse. Diese Spannungsquelle kann eine Elektrode von einem anderen Stück der Anlage sein, die aufgrund eines Fehlers derselben stromführend wurde.

- 2 -

509809/0368

Diese Elektroschockgefahr kann durch Isolieren eines Ausgangskreises des elektrochirurgischen Generators gegenüber Masse verhindert werden, um dem Stromfluß mit der Leistungsversorgungsfrequenz einen großen Widerstand zur Masse entgegenzusetzen. Jedoch führt diese Art des isolierten Ausgangskreises selbst zu einer Gefahr, da das Ausgangssignal des elektrochirurgischen Generators zwischen dem Plattenkreis und Masse erscheinen kann. Hierdurch könnten dem Patienten oder einer anderen, sich in Berührung mit dem Plattenkreis befindlichen Person im Energiezustand des Generators Verbrennungen zugefügt werden. Dieser Zustand kann eintreten, wenn zwischen dem aktiven Ausgangsanschluß und Masse eine kleine Impedanz vorliegt, beispielsweise wenn die aktive Elektrode auf geerdetem Metall angeordnet wird.

In bekannter Weise ist es für eine sichere Benutzung einer elektrochirurgischen Vorrichtung notwendig, sicherzustellen, daß die Plattenelektrode mit dem Generator verbunden ist und daß die gesamte Verbindungsleitung Durchgang hat. Bisher wurde üblicherweise in einem elektrochirurgischen Generator ein Überwachungskreis eingebaut, der einen kleinen Strom durch den Plattenelektrodenkreis leitet, wobei ein Relais oder eine ähnliche Einrichtung den Stromdurchgang nach Vervollständigung des Kreises erfaßt. Das Relais kann so angeordnet sein, daß ein Alarmsignal erzeugt wird, wenn der Durchgang des Plattenkreises verschwindet. Dieses System hat bestimmte und insbesondere folgende Nachteile: (a) Es ist eine doppeladrigte Leitungsplatten-Elektrodenleitung erforderlich, (b) der Überwachungsstrom kann zu einer Elektroschockgefahr führen, (c) der Überwachungsstrom kann die Patientenüberwachungsvorrichtung stören und (d) der Überwachungskreis erfordert zusätzliche mit dem Plattenelektrodenkreis verbundene Kreiskomponenten, wodurch das Aufrechterhalten einer ausreichenden elektrischen Isolation erschwert wird.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung eines elektrochirurgischen Generators mit einem isolierten Ausgangskreis unter Vermeidung einer Diathermyverbrennungsgefahr vom Plattenkreis. Ferner soll die Notwendigkeit einer Überwachung

Zur Lösung der gestellten Aufgabe zeichnet sich eine elektrochirurgische Vorrichtung erfindungsgemäß aus durch eine Überwachungseinrichtung in Form eines spannungserfassen<sup>+</sup>-Kreises, der beim Ansteigen der Spannung der Vorrichtung in bezug auf Erde bzw. Masse über einen vorbestimmten Wert anspricht, um ein Steuersignal zu erzeugen, und durch eine auf dieses Steuersignal ansprechende Einrichtung zum Abschalten der Vorrichtung und/oder zum Erzeugen eines Alarmsignals.

+ ) den

Die Erfindung wird nachfolgend an einem zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiel in Form eines elektrischen Schaltkreises näher erläutert.

- 4 -

Dieser Spannungserfassungs- bzw. -überwachungskreis ist mit einem Elektrodenkreis einer Diathermyvorrichtung verbunden, wobei ein solcher Elektrodenkreis über Anschlüsse 1, die mit einer Generatorausgangsspule 2 des Elektrodenkreises gekoppelt sind, mit einer Plattenelektrode verbunden ist. Die Verbindung zwischen dem Überwachungskreis und dem Elektrodenkreis weist einen Kondensator 3 auf, dessen Kapazitätswert ausreichend klein ist, um nicht die Kapazität des Elektrodenkreises spürbar zu vergrößern. Der Kondensator 3, der durch einen Widerstand, einen Miniaturtransformator oder einen optisch gekoppelten Isolator ersetzt werden kann, stellt eine Einrichtung dar, mittels derer ein kleiner Teil des Generatorausgangs vom Elektrodenkreis zum Überwachungskreis übertragen werden kann. Der Spannungserfassungskreis enthält einen Halbwellengleichrichterkreis mit einer Diode 4, einem Kondensator 5 und einem Widerstand 6. Dieser Gleichrichterkreis erzeugt eine Gleichspannung an einem Eingang 7 eines Operationsverstärkers 8. Ein anderer Eingang 9 des Operationsverstärkers 8 liegt an einer variablen und von einem Potentiometer 10 abgeleiteten Referenzspannung. Der Operationsverstärker 8 wirkt als Triggerkreis, da sein Ausgangssignal schnell von einer maximalen negativen Spannung zu einer maximalen positiven Spannung verändert wird, wenn die Spannung am Widerstand 6 des Halbwellengleichrichterkreises eine Referenzspannung übersteigt, die durch Einstellen des Potentiometers 10 vorbestimmt wurde.

Das vom Verstärker 8 erzeugte Signal stellt ein zu einer Relais-schaltereinrichtung 11 geführtes Steuersignal dar. Wenn dieses Signal an das Relais 11 angelegt wird, arbeitet dieses so, daß die Energieversorgung eines Diathermygenerators unterbrochen wird und daß eine Alarmlampe 12 aufleuchtet oder ein hörbarer Alarm erzeugt wird. Vorzugsweise enthält die Relaischaltereinrichtung 11 eine Verriegelung, um ein erneutes Anlegen der Versorgung zu vermeiden, nachdem das Eingangssignal auf Null gefallen ist. Die Verriegelung kann entweder elektrisch oder mechanisch ausgebildet sein und entweder durch den Betrieb einer Steuerung oder automatisch durch eine andere Einrichtung im Kreis zurückgestellt bzw. aufgehoben werden. Die Vorrichtung ist mit

einem Rückstellschalter 13 versehen, mit dem die Energieversorgung des Generators wieder hergestellt werden kann. Oder der Rückstellschalter kann, sofern es erwünscht ist, so angeordnet sein, daß er bei Wegfall der Fehlerbedingungen automatisch arbeitet.

Statt einer Relaisschalteinrichtung 11 kann auch ein Halbleiterschalter (entweder ein Transistor oder ein Thyristor) vorgesehen sein. Ferner kann sich der Verstärker 8 in bestimmten Fällen als überflüssig erweisen, wenn der Leistungs- bzw. Spannungspegel ausreicht, um den Schalter direkt zu betätigen.


- Patentansprüche -

Patentansprüche

1. Elektrochirurgische Vorrichtung, gekennzeichnet durch eine Überwachungseinrichtung in Form eines spannungsabhängigen Kreises (8), der beim Ansteigen der Spannung der Vorrichtung in bezug auf Erde bzw. Masse über einen vorbestimmten Wert anspricht, um ein Steuersignal zu erzeugen, und durch eine auf dieses Steuersignal ansprechende Einrichtung (11) zum Abschalten der Vorrichtung und/oder zum Erzeugen eines Alarmsignals.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen mit Elektroden, die sich in Kontakt mit einem Patienten befinden, verbindbaren Generatorkreis, durch einen Überwachungskreis mit einem Gleichrichter (4) und einem Triggerkreis (8) zum Betätigen eines Schalters (11) und durch eine Einrichtung (3), mittels derer ein Teil des Ausgangssignals des Generatorkreises zum Überwachungskreis übertragen werden kann.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Triggerkreis ein Verstärker (8) ist, dessen einer Eingang (9) mit einem Potentiometer (10) verbunden ist, mit dem diesem Eingang eine variable Referenzspannung zugeführt werden kann, und dessen anderer Eingang (7) an der zu erfassenden Spannung anliegt, während das Ausgangssignal des Verstärkers schnell von einer maximalen negativen Spannung zu einer maximalen positiven Spannung veränderbar ist, wenn die Referenzspannung erreicht ist, um dadurch ein Signal zum Betätigen des Schalters (11) zu erzeugen.
4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, ferner gekennzeichnet durch eine Verriegelungseinrichtung, mittels derer der Schalter (11) nach einem Betätigen durch ein Signal vom Triggerkreis (8) an einem Wiedereinschalten gehindert wird.



NACHGEREICHT

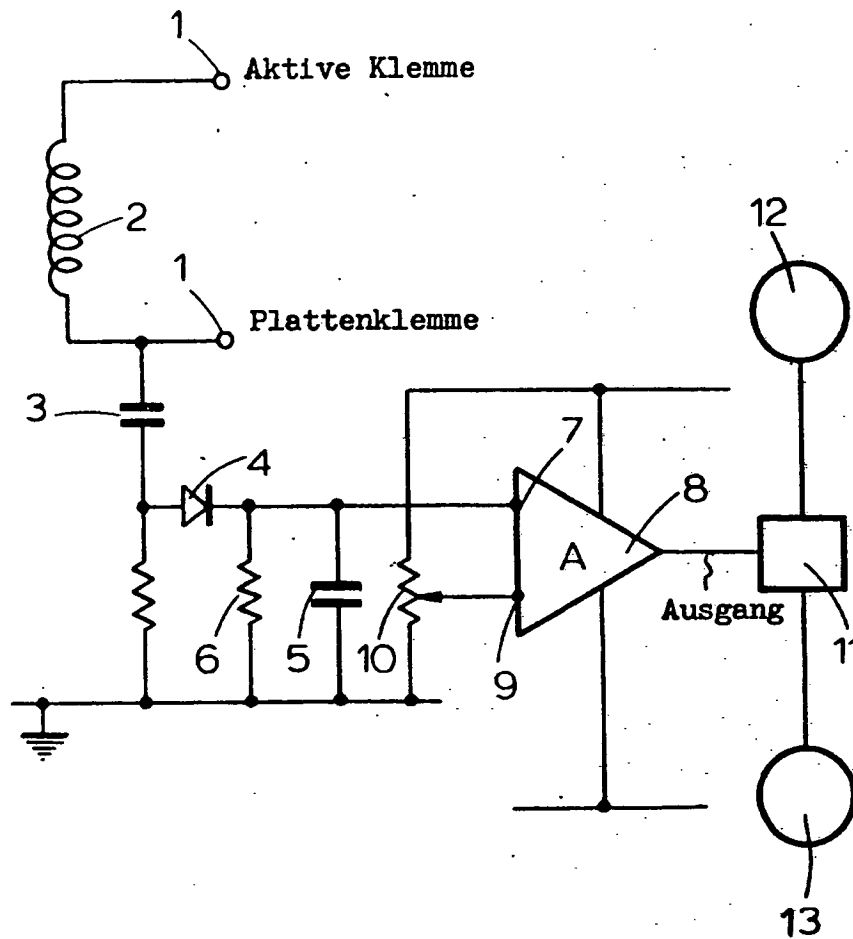

A61N 3-00 AT 17.08.1974 DT: 27.02.1975

50980970368